

医療関係者各位

「医薬品の封の取扱い等について」に関する情報掲載について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成30年8月1日に厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された（薬生発0801第1号）「医薬品の封の取扱い等について」に基づき、弊社が製造販売する医療用医薬品の封に関する情報について、弊社ホームページ（<https://www.arax.co.jp/seihin/iyaku.html#i01>）に掲載いたしましたので、謹んでご案内申し上げます。

謹白

弊社が販売する医療用医薬品の封の状態について、以下の内容を紹介いたします。

対象製品：チェックワンファスト（医療用医薬品）

未開封の確認方法及び正しい開封方法について

① 未開封の状態

- ミシン目が切れていない
- 開封側面がしっかり糊付けされている




② 開封方法

- 開封口からミシン目に沿って、ゆっくりと押し開け、開封してください



③ 開封後の状態

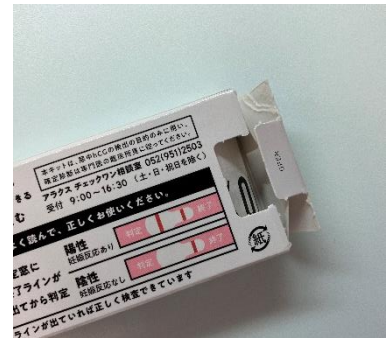

すでに開封されている可能性のある状態について

- ミシン目が切れている
- 糊付け部分がはがれている



以上